BILANZ 2023 - AUSBLICK 2024

Zukunft Diagnostik

VDGH

Ihre Gesprächspartner



Ulrich Schmid Vorsitzender




Dr. Martin Walger
Geschäftsführer



Torsten Kiesner Moderation



Ablauf

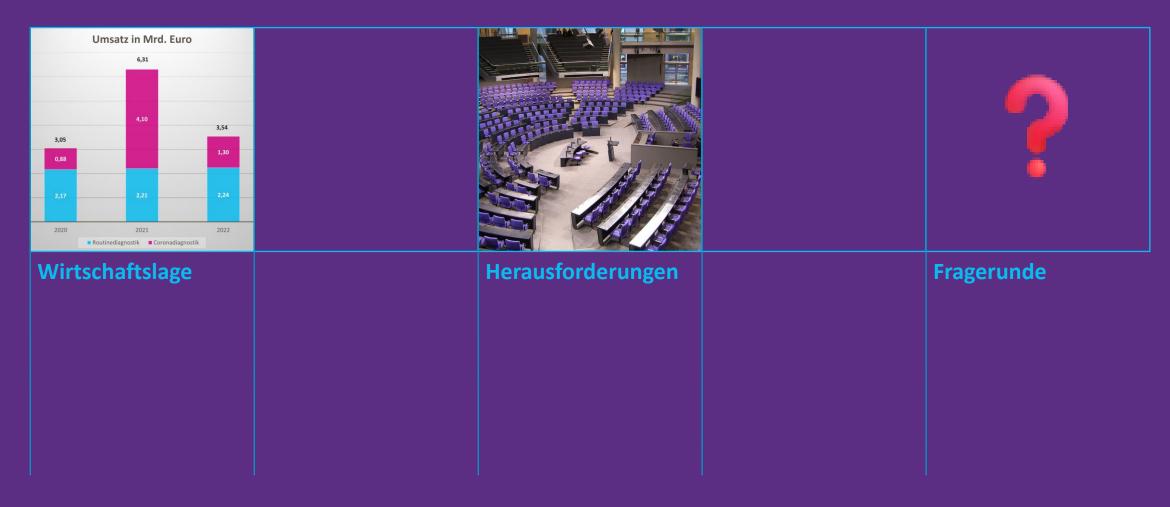



VDGH-Pressegespräch – Ulrich Schmid VDGH-Marktdaten




IVD-Markt Deutschland 2021 - 2023

Umsatz 2023: 2,33 Mrd. Euro


Marktwachstum 2023/22: - 36 Prozent

Coronadiagnostik: 5 Prozent Anteil

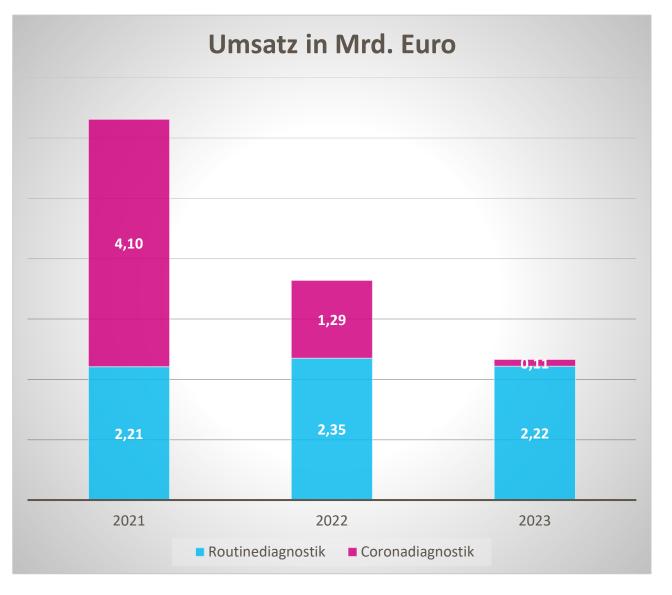



Life-Science-Research

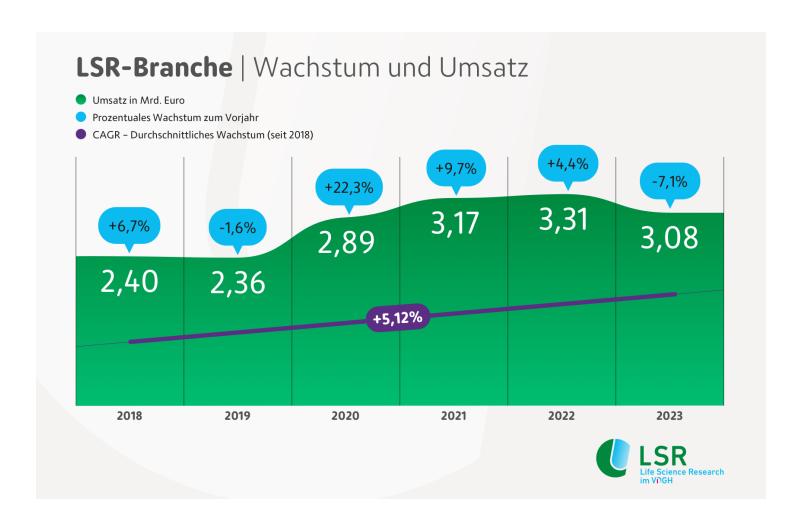




VDGH-Pressegespräch – Ulrich Schmid

VDGH-Umfrage Erwartungen 2024




Die Stimmung ist ambivalent

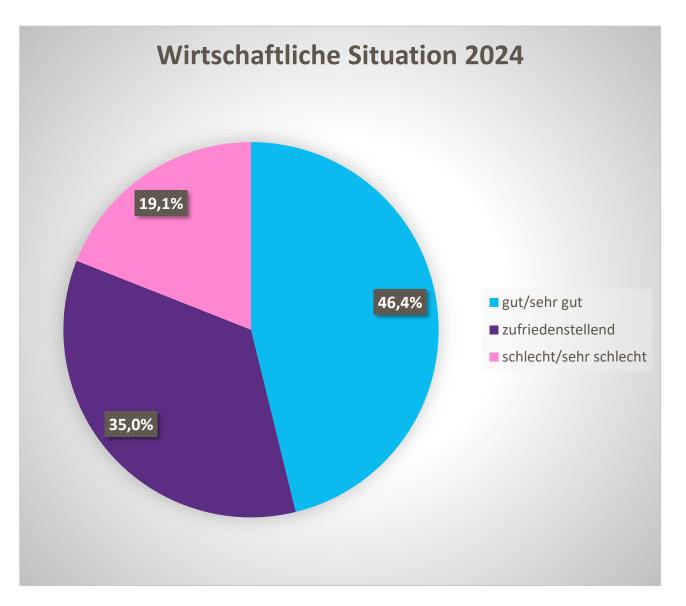




Umsatzerwartungen 2024: mehrheitlich positiv

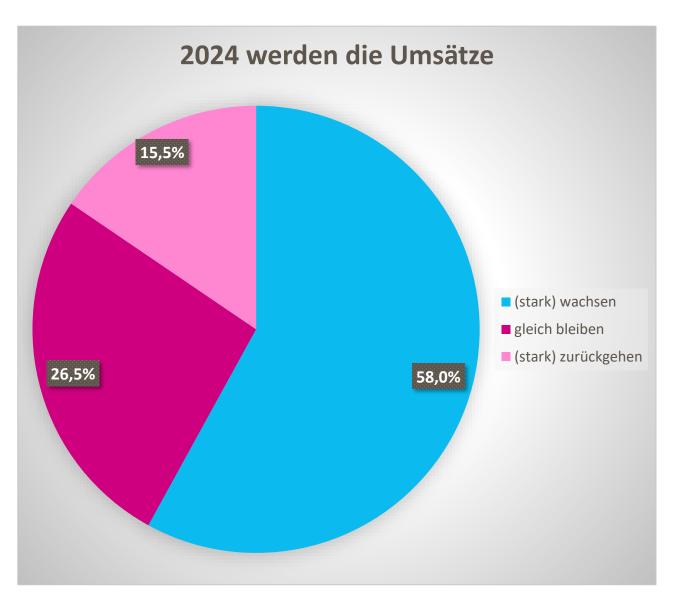




Beschäftigungsentwicklung – leicht positiv

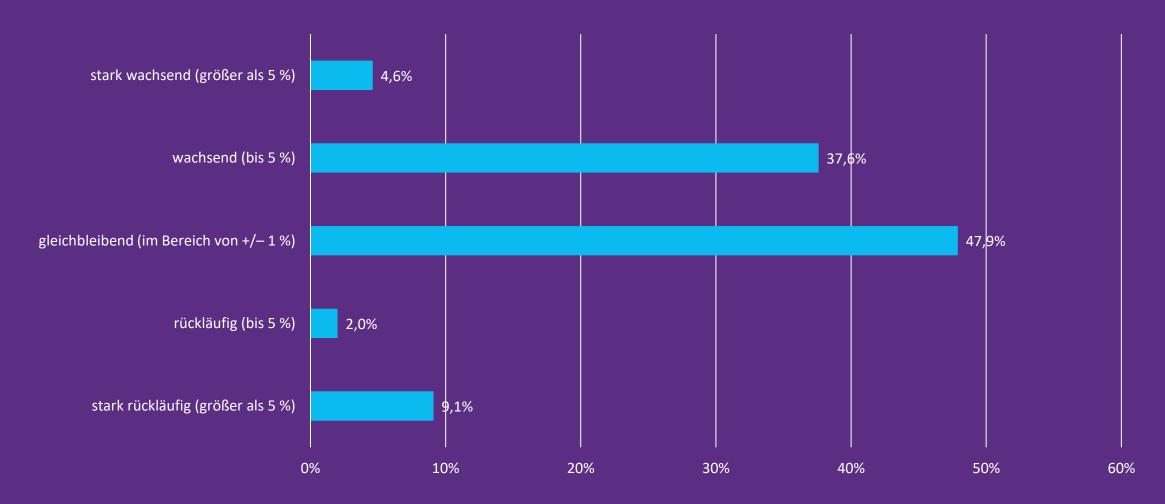




Die Kehrseite: Fachkräftemangel hoch wie nie

"Fachkräftemangel ist relevant" sagen...

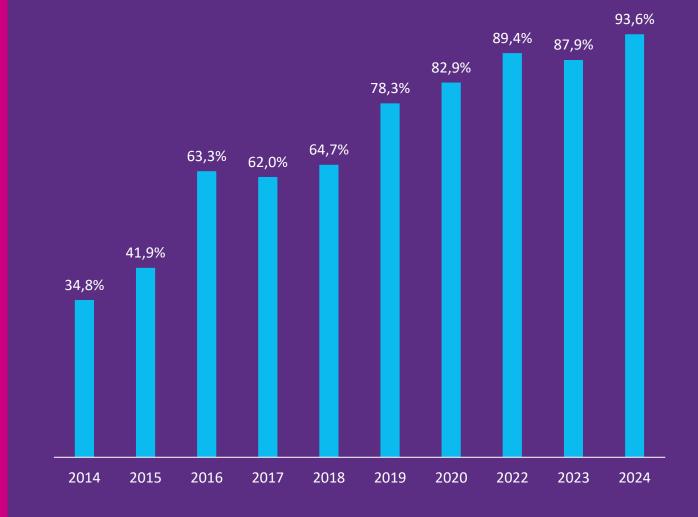




Unsere Unterstützung: www.viele-wege.de

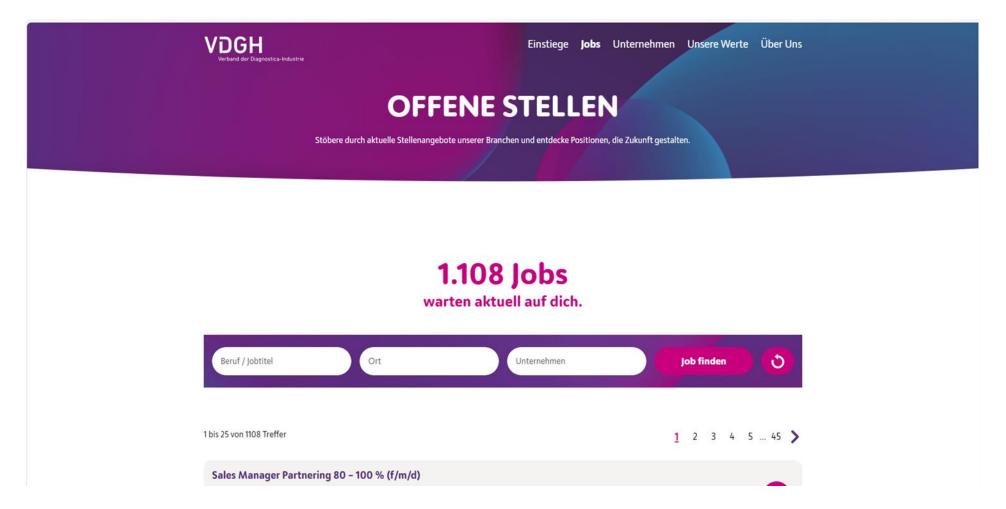



Ausblick Investitionen 2024:

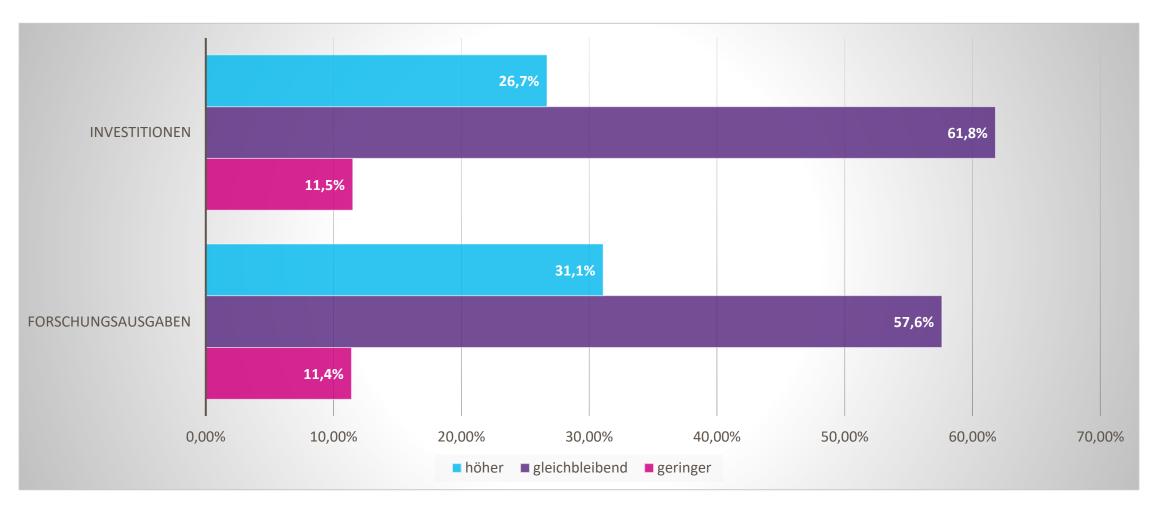







Was bremst die Labordiagnostik?





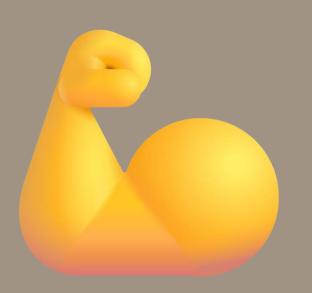


Stärken des Standortes Deutschland

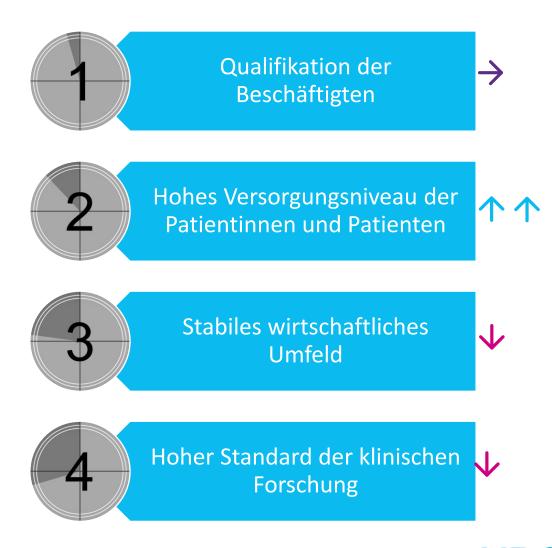



IVD-Markt Deutschland ist...

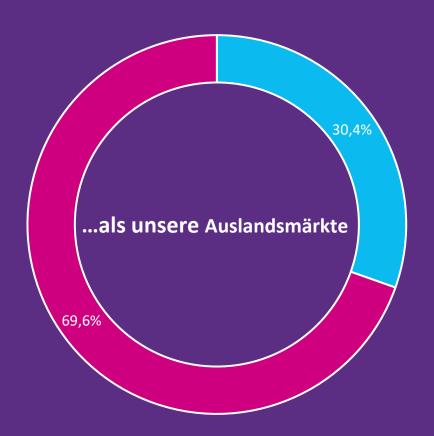

besser

schlechter



VDGH-Pressegespräch – Dr. Martin Walger Was uns noch bewegt: Ausblick



Digitalisierung


- "Daten helfen heilen"
- Inkrafttreten wichtiger Gesetzgebungen im März 2024:
 - Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens
 - Gesundheitsdatennutzungsgesetz
- Große Relevanz für die Diagnostika-Industrie
 - Telemedizin/Videosprechstunde
 - Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten zu Forschungszwecken
 - Diagnostika und Künstliche Intelligenz
 - Digitale Gesundheits-/Pflegeanwendungen (DiGA/DiPA)










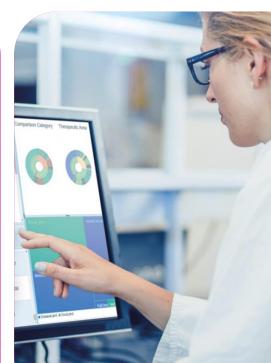


Bedeutung der Digitalisierung steigt

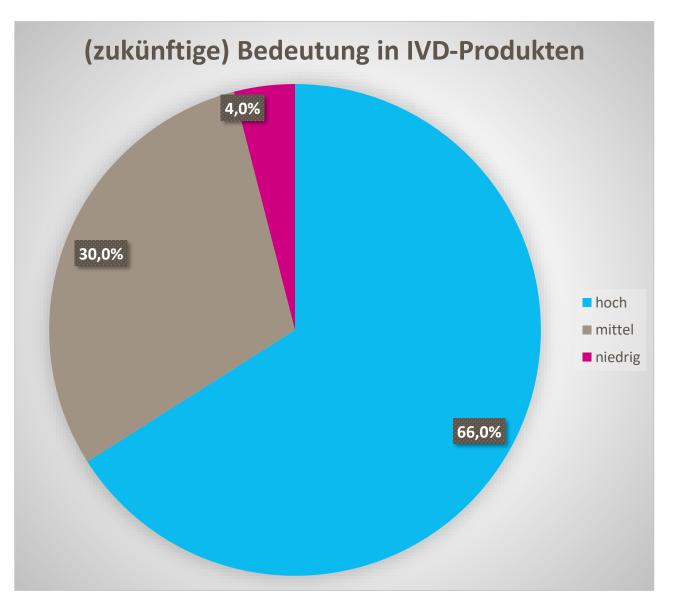




KI hält Einzug

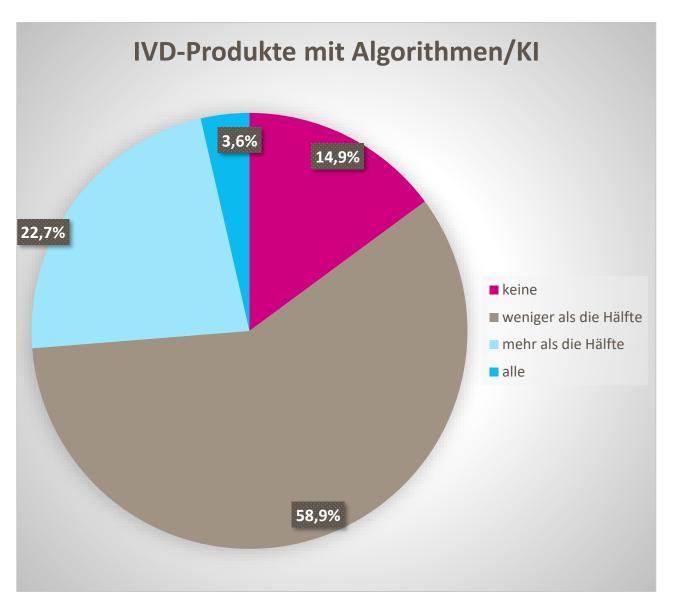



KI in der Diagnostik

Rahmenbedingungen für die Industrie

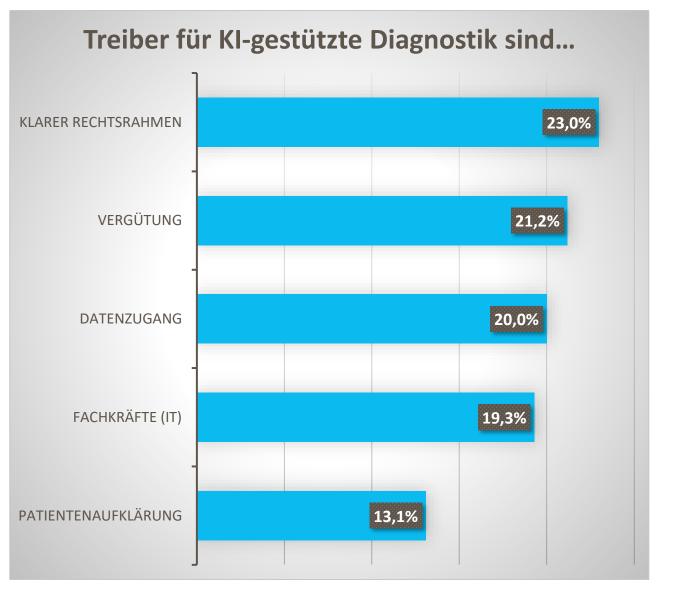



- Europa setzt den Rahmen für die Produktzulassung und -überwachung (IVD-Verordnung)
- Neuer Vorschlag EU-KOM (23.1.2024): Verlängerung der Übergangszeiten um jeweils 2,5 Jahre
 - Klasse-D-Produkte bis Dezember 2027
 - Klasse-C-Produkte bis Dezember 2028
 - Klasse-B und Klasse-A (steril)-Produkte bis Dezember 2029
- Das Risiko von Versorgungsengpässen wird damit gemindert
- Verfahren muss vor der Europawahl (Juni 24) abgeschlossen sein
- Und: Eine grundsätzliche Evaluation und Überarbeitung der IVD-Verordnung ist erforderlich





VIELEN DANK

Fragen? Fragen.

VDGH